www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АППАРАТАХ
VERAS 5

ОПИСАНИЕ

Veras 5 предлагает надежную слуховую систему с уникальными свойствами, предоставляющими высокое звуковое разрешение для любых аудиологических потребностей. Ноу хау Бернафона «Бесканальный» звуковой процессор комбинирован с большим количеством адаптивных свойств. Veras 5 особенно разнообразен, предоставляя шесть стилей аппаратов, множество цветов и много акустических опций.

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ

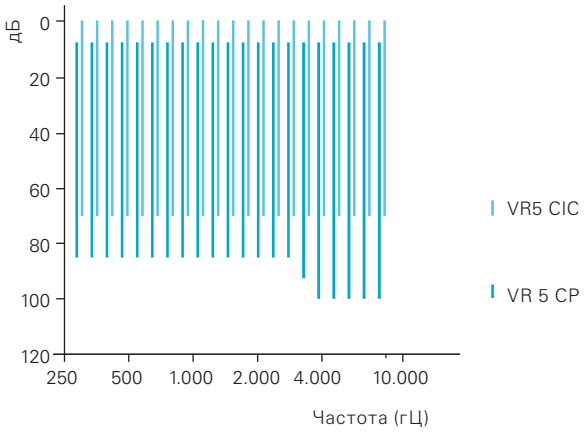

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесканальный (Bernafon ChannelFree™) цифровой звуковой
- 8 кГц частотный диапазон
- Беспроводная координация
  - Регулятора громкости и переключения
- Адаптивная направленность
- Адаптивная система шумоподавления с 2 уровнями
- Адаптивная система добавления фидбэка
- Мульти-акустическая программа
- Совершенный менеджер тихих звуков
- Определение Авто телефона

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ

- Профиль Стиля жизни
- Даталогинг
- 9 опций слуховых программ
- 3 свободно-настраиваемые программы
- Привлекательный дизайн с множеством цветов и стилей
- В опции ПА/ ФМ адаптер
- В опции дистанционное управление RC-P

bernafon
Your hearing · Our passion

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Верас программируется с Бернафон Оазис версия 11.0 или выше. Минимальная конфигурация:
Windows XP или выше
NOAH 3.5.2 или выше

Программ. Кабель. N2 New standard (HiPro)
синий, левый 384-20-033-00
Программ. Кабель. N2 New standard (HiPro)
Красный, правый 384-20-032-00
Программ. Кабель. N2 New standard(NOAHlink)
синий, левый 384-20-035-00
Программ. Кабель. N2 New standard (NOAHlink
Красный, правый 384-20-034-00
Адаптеры для программирования
BTE CP/M 399-50-640-00
ITCD 390-01-040-00
ITC/CIC 390-01-180-05

КОМПАКТНАЯ ЗАУШИНА (BTE)

VR5 CP



МИКРО ЗАУШИНА (BTE)

VR5 M



НАНО ЗАУШИНА (BTE)

VR5 N



		2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА	2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА	2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА
УЗД 90, пик	дБ SPL	127	134	115	126	121	127
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	122	130	114	120	121	127
Усредненное УЗД на высоких частотах OSPL 90	дБ SPL	119	–	107	–	115	–
Полное усиление (ВУЗД), пик	дБ	61	66	51	62	50	55
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	дБ	55	63	50	56	50	55
HFA Полное усиление	дБ	53	–	42	–	43	–
Референтный тест УЗД	дБ	41	55	31	46	38	48
Выбор программ		●		●		●	
Местный Регулятор Громкости		●		●			
Телефонная катушка		●		●			
Определение Автотелефона		●		●			
ФМ адаптер		○		○			
ПА адаптер		○		○			
Тип батареи		13		312		312	
Звуковой крючок		●		●		●	
Спирафлекс тонкая трубка 0.9 / 1.3		●		●		●	
Система направленного микрофона		Напр		Напр		Напр	
Дистанционное управление RC-P		○		○		○	

● Стандарт ○ опция

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22.
"2см" тесты согласно IEC 60318-5.
"Симулятор уха" тесты соглсано IEC 60711.
Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2003.

ЦВЕТА ЗАУШИН

Все цвета имеются в наличии для всех стилей заушин.

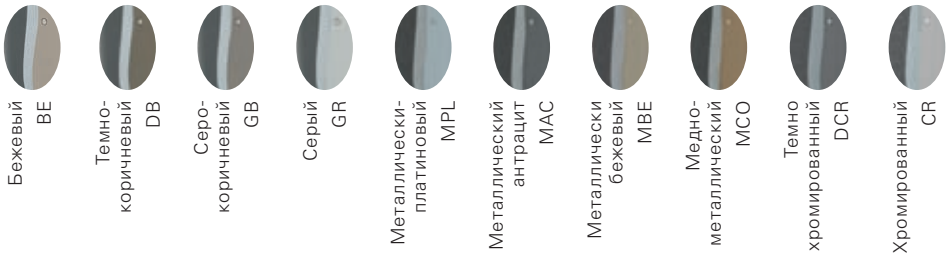

ITCD	ITC	CIC

VR5 ITCD



VR5 ITC



VR5 CIC



		2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА	2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА	2КУБ КАМЕРА	СИМУЛЯТОР УХА
УЗД 90, пик	дБ SPL	113	123	113	124	109	118
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	107	115	107	116	101	109
Усредненное УЗД на высоких частотах OSPL 90	дБ SPL	108	–	108	–	102	–
Полное усиление, пик	дБ	46	56	46	56	39	49
Полное усиление, 1600 Гц	дБ	39	47	39	47	32	40
HFA Полное усиление	дБ	41	–	40	–	33	–
Референтный тест УЗД	дБ	31	39	32	39	26	33
Выбор программ		○		○			
Местный Регулятор Громкости		○		○			
Телефонная катушка		○		○			
Определенние Автотелефона		●					
ФМ адаптер		нет		нет		нет	
ПА адаптер		нет		нет		нет	
Тип батареи		312		312		10	
Звуковой крючок нет в наличии		нет		нет		нет	
Спирафлекс тонкая трубка 0.9 / 1.3		нет		нет		нет	
Система направленного и разнонаправленного микрофона		Напр.		Разнонапр		Разнонапр	
Дистанционное управление RC-P		○					

● Стандарт ○ опция

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22.
"2см" тесты согласно IEC 60318-5.
"Симулятор уха" тесты согласно IEC 60711.
Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2003.

ЦВЕТА ВНУТРИУШНЫХ

Для внутриушных аппаратов возможны следующие цвета:

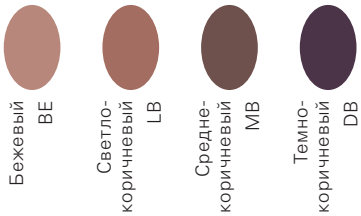

VR5 CP
ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК

VR5 CP
СПИРАФЛЕКС 1.3

VR5 CP
СПИРАФЛЕКС 0.9

Измерения со звуковым крючком без фильтра
Измерения со звуковым крючком с фильтром
Измерения с тонкой трубкой 1.3
Измерения с тонкой трубкой 0.9

2 КУБОВАЯ КАМЕРА

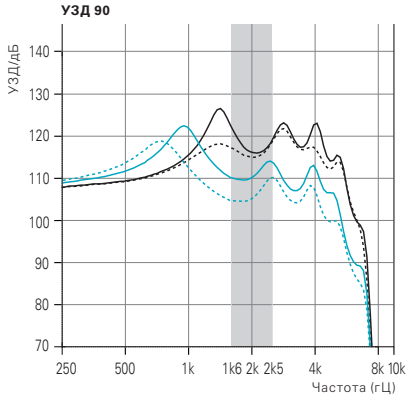

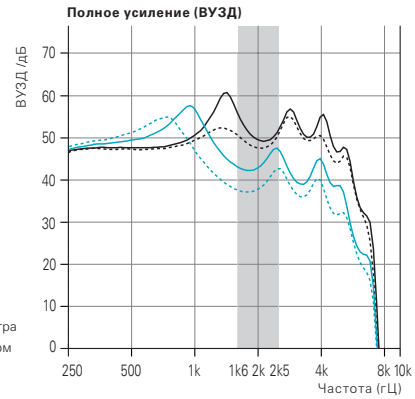

"СИМУЛЯТОР УХА"

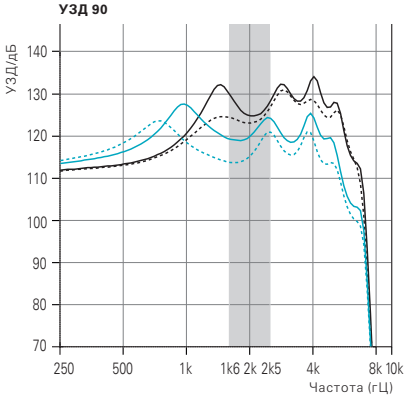

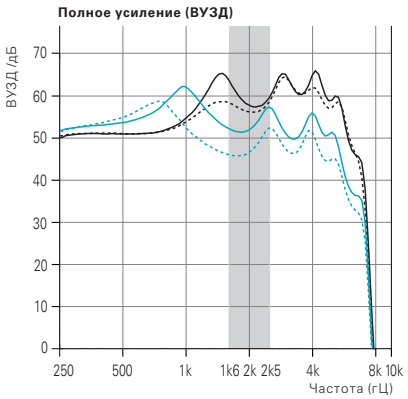

		2 КУБОВАЯ КАМЕРА			"СИМУЛЯТОР УХА"		
		ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	СПИРАФ-ЛЕКС 0.9	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	СПИРАФ-ЛЕКС 0.9
УЗД 90, пик	дБ SPL	127	123	119	134	128	124
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	122	110	105	130	120	114
Усредненное УЗД на высоких частотах OSPL 90	дБ SPL	119	115	109	–	–	–
Полное усиление (ВУЗД), пик	дБ	61	57	55	66	62	59
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	дБ	55	43	37	63	52	46
Усредненное ВУЗД на высоких частотах OSPL 90	дБ	53	48	42	–	–	–
Референтный тест УЗД	дБ	41	37	31	55	44	38
Ток покоя	мА	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Оперативный ток потребления	мА	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
Тип батареи			13			13	
Искажения 500/800/1600 гЦ	%	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<2/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
Частотный диапазон	Гц	100–6100	100–5400	100–5800	–	–	–
Эквивалентный вносимый шум [1]	дБ SPL	19	17	22	18	22	25
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Hz	дБ SPL	81	70	65	90	79	74
Усредненный уровень звукового давления на высоких частотах для телефонной катушки, ANSI	дБ SPL	95	92	87	–	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[1] Технические тесты, с расширением, согласно установке бокс-анализатора.

"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22.
"2см" тесты согласно IEC 60318-5. «Симулятор уха» тесты согласно IEC 60711.
Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2003.

VR5 M
ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК

VR5 M
СПИРАФЛЕКС 1.3

VR5 M
СПИРАФЛЕКС 0.9

Измерения со звуковым крючком без фильтра
Измерения со звуковым крючком с фильтром
Измерения с тонкой трубкой 1.3
Измерения с тонкой трубкой 0.9

2 КУБОВАЯ КАМЕРА

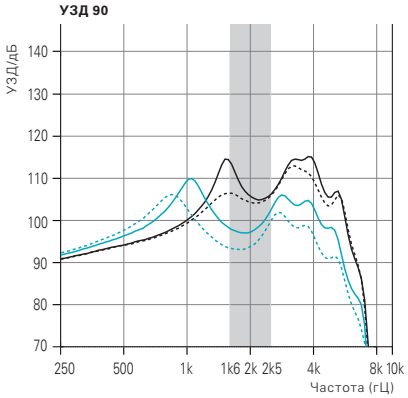

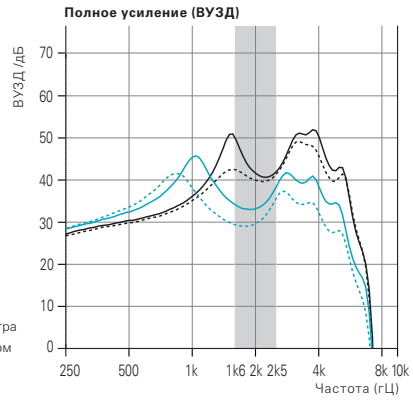

"СИМУЛЯТОР УХА"

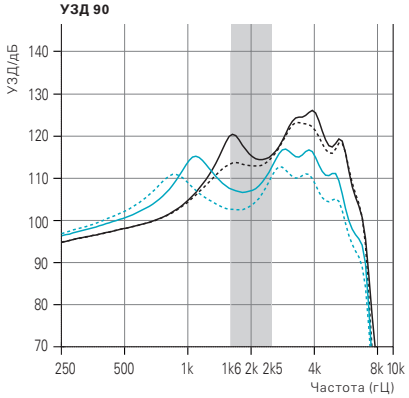

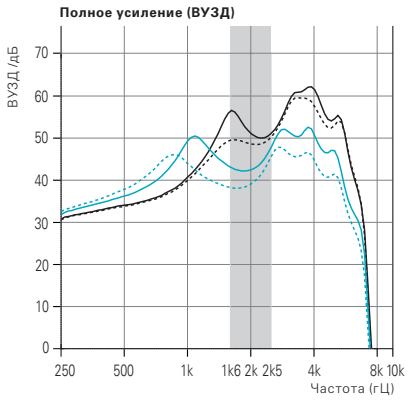

		2 КУБОВАЯ КАМЕРА			"СИМУЛЯТОР УХА"		
		ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	SPIRA FLEX 0.9	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	СПИРАФ-ЛЕКС 0.9
УЗД 90, пик	дБ SPL	115	110	106	126	117	113
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	114	98	93	120	108	103
Усредненный уровень УЗД на высоких частотах 90	дБ SPL	107	103	99	–	–	–
Полное усиление (ВУЗД), пик	дБ	51	45	41	62	53	48
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	дБ	50	34	29	56	43	38
Усредненное ВУЗД на высоких частотах OSPL 90	дБ	42	39	34	–	–	–
Референтный тест УЗД	дБ	31	27	23	46	33	28
Ток покоя	мА	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Оперативный ток потребления	мА	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
Тип батареи		312			312		
Искажения 500/800/1600 гЦ	%	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
Частотный диапазон	Гц	150–6500	110–6000	100–6200	–	–	–
Эквивалентный вносимый шум [1]	дБ SPL	24	20	22	20	24	24
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Hz, IEC	дБ SPL	77	62	57	84	71	66
Усредненный уровень звукового давления на высоких частотах для телефонной катушки ANSI	дБ SPL	86	83	79	–	–	–

[1] Технические тесты, с расширением, согласно установке бокс-анализатора.

СПИРАФЛЕКС НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Продукты	Описание	Каталожный номер
Спирафлекс набор для настройки	Все части спирафлекс	890-80-060-00
Спирафлекс набор для настройки (уменьшенный)	Все части Нано заушины: 10x крючков Нано Заушины 10x Спирафлекс адаптер Нанозаушины	890-80-190-00

VR5 N
ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК

VR5 N
СПИРАФЛЕКС 1.3

VR5 N
СПИРАФЛЕКС 0.9

Измерения со звуковым крючком без фильтра
Измерения со звуковым крючком с фильтром
Измерения с тонкой трубкой 1.3
Измерения с тонкой трубкой 0.9

2 КУБОВАЯ КАМЕРА

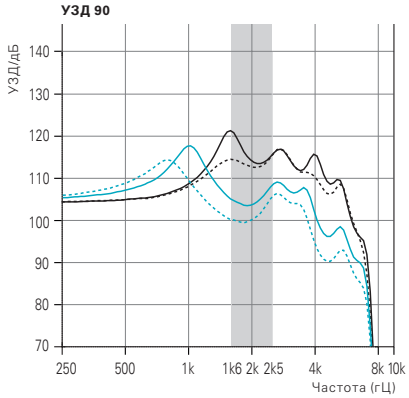

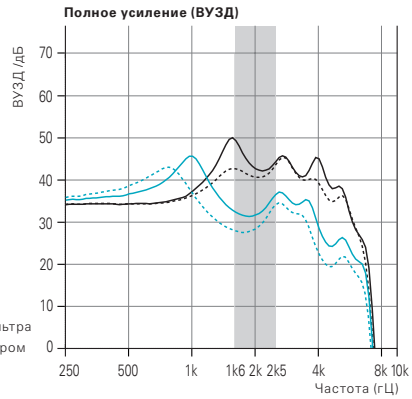

"СИМУЛЯТОР УХА"

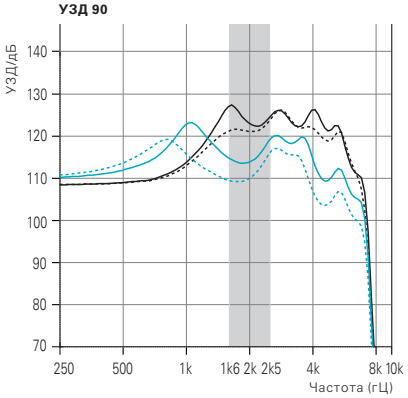

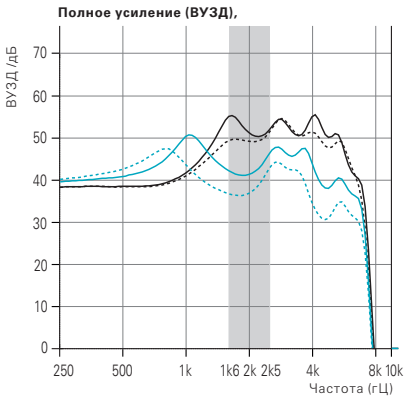

		2 КУБОВАЯ КАМЕРА			"СИМУЛЯТОР УХА"		
		ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	СПИРАФ-ЛЕКС 0.9	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК	СПИРАФ-ЛЕКС 1.3	СПИРАФ-ЛЕКС 0.9
УЗД 90, пик	дБ SPL	121	118	115	127	123	119
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	121	105	101	127	115	109
Усредненное УЗД на высоких частотах 90	дБ SPL	115	110	105	–	–	–
Полное усиление (ВУЗД), пик	дБ	50	46	43	55	51	47
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	дБ	50	32	28	55	42	37
Усредненное ВУЗД на высоких частотах 90	дБ	43	38	33	–	–	–
Референтный тест УЗД	дБ	38	32	27	48	35	30
Ток покоя	мА	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Оперативный ток потребления	мА	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Тип батареи		312			312		
Искажения 500/800/1600 гЦ	%	<2/<2/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<2/<2/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
Частотный диапазон	гЦ	100 – 6900	100 – 6800	100 – 6700	–	–	–
Эквивалентный вносимый шум [1]	дБ SPL	11	13	18	10	15	17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[1] Технические тесты, с расширением, согласно устновке бокс-анализатора.

"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22.
"2см" тесты согласно IEC 60318-5.
"Симулятор уха" тесты соглсано IEC 60711.
Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2003.

VR5 ITCD

VR5 ITC

VR5 CIC

ITCD
ITC
CIC

2 КУБОВАЯ КАМЕРА

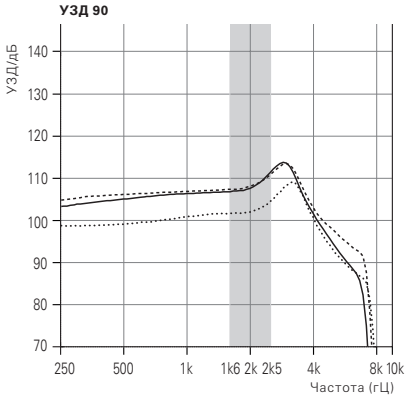

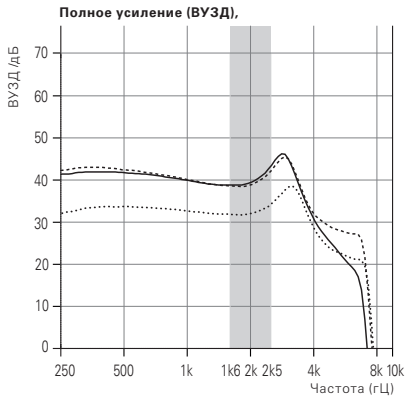

"СИМУЛЯТОР УХА"

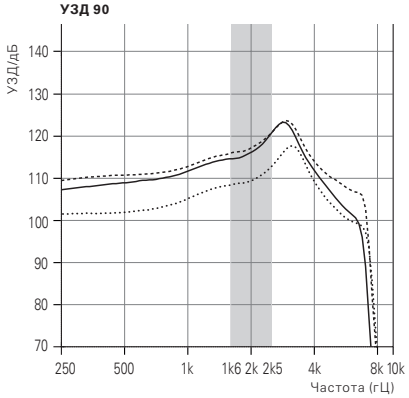

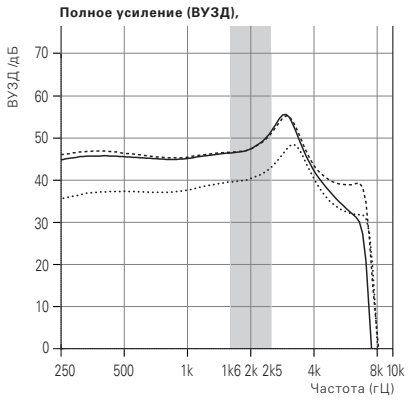

		2 КУБОВАЯ КАМЕРА			"СИМУЛЯТОР УХА"		
		ITCD	ITC	CIC	ITCD	ITC	CIC
УЗД 90, пик	дБ SPL	113	113	109	123	124	118
УЗД 90, 1600 Гц	дБ SPL	107	107	101	115	116	109
Усредненное УЗД на высоких частотах 90	дБ SPL	108	108	102	–	–	–
Полное усиление ВУЗД, пик	дБ	46	46	39	56	56	49
Полное усиление ВУЗД, 1600 Гц	дБ	39	39	32	47	47	40
Усредненное ВУЗД на высоких частотах 90	дБ	41	40	33	–	–	–
Референтный тест УЗД	дБ	31	32	26	39	39	33
Ток покоя	мА	1.2	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8
Оперативный ток потребления	мА	1.3	0.9	0.9	1.2	0.8	0.8
Тип батареи		312	312	10	312	312	10
Искажения 500/800/1600 гЦ	%	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
Частотный диапазон	гЦ	100–5600	100–7300	100–7300	–	–	–
Эквивалентный вносимый шум [1]	дБ SPL	18	20	22	20	22	23
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Hz, IEC	дБ SPL	68	66	–	76	74	–
Усредненный уровень звукового давления на высоких частотах для телефонной катушки, ANSI	дБ SPL	85	84	–	–	–	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[1] Технические тесты, с расширением, согласно устновке бокс-анализатора.

"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22.
"2см" тесты согласно IEC 60318-5.
"Симулятор уха" тесты соглсано IEC 60711.
Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2003.

ПРОДУКТЫ

Продукты	Описание	Каталожный номер
Дистанционное управление	Remote control	160-02-350-00
ПА адаптер	Совместим Верас микро и компактной заушин	399-50-521-00
ФМ адаптер	Совместим Верас микро и компактной заушин	399-50-591-00

ОПЦИИ АКУСТИКИ

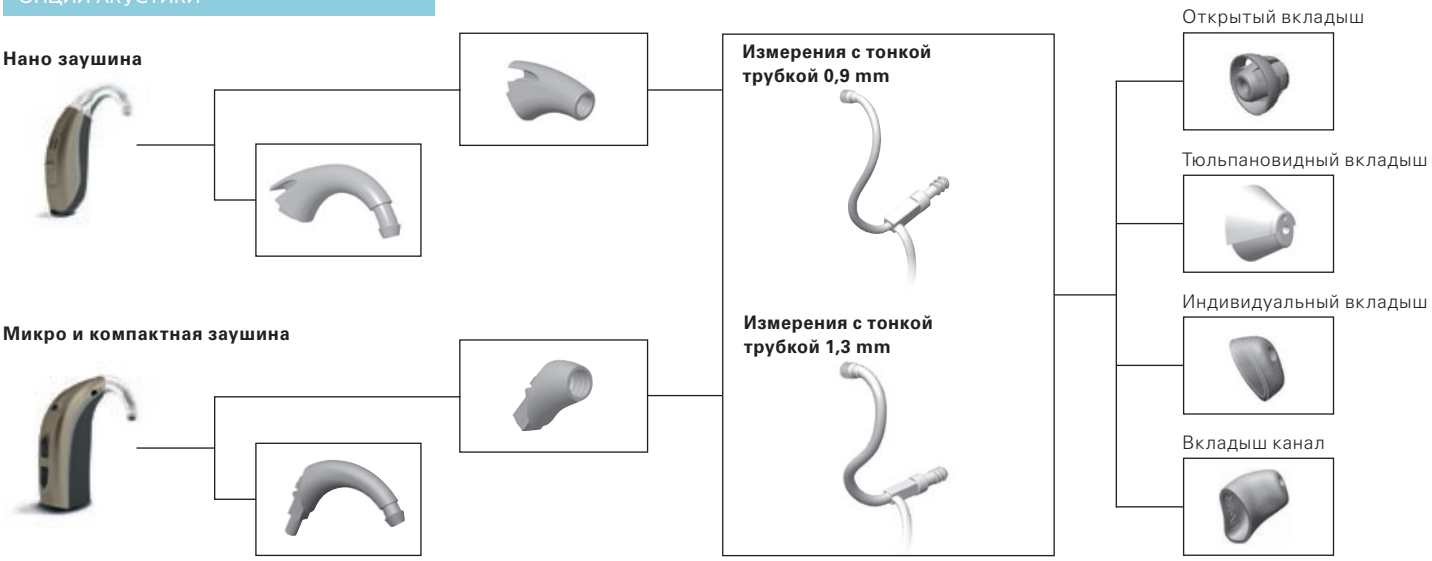

11.09/BAG/951-20-460-00/subject to change

SWISS Engineering

bernafon
Your hearing · Our passion

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки
глюкометры массажеры
тонометры миостимуляторы
соляные лампы алкометры
физиотерапевтические аппараты